



コスモ・バイオ株式会社  
COSMO BIO CO., LTD.

研究用試薬

---

**YK230 Mouse/Rat Obestatin EIA**

---

**取扱説明書**

---

FOR RESEARCH LABORATORY USE ONLY

株式会社 矢内原研究所

〒418-0011 静岡県富士宮市粟倉 2480-1

FAX: 0544-22-2770 TEL: 0544-22-2771

Website: [www.yanaihara.co.jp](http://www.yanaihara.co.jp) E-mail: [ask@yanaihara.co.jp](mailto:ask@yanaihara.co.jp)

## 目 次

I. はじめに	2
II. 特徴	3
III. キットの構成	4
IV. 操作法	5-6
V. 操作上の注意	6-7
VI. 基本性能	7
VII. 貯蔵法および有効期間	8
VIII. 文献	8

## YK230 Mouse/Rat Obestatin EIA キット

### I. はじめに

Obestatinは、ラットの胃から分離された 23 残基のアミノ酸からなるペプチドであり、前駆体を共有し、摂食亢進作用を持つ Ghrelin に対し、摂食抑制作用を示し、さらに胃内容排出や空腸の収縮に対し、抑制作用も持っていることが明らかにされています<sup>(1)</sup>。ラット組織の免疫染色では、Obestatinは胃の粘膜細胞、腸管神経叢、精巣のLeydig 細胞に存在し、また、腸管神経叢のObestatin陽性神経細胞はほぼすべてCholine acetyltransferaseと共存しています<sup>(2)</sup>。ラット大脳皮質神経培養実験では、100nM Obestatin 处理により、細胞質内Caイオン濃度が上昇することが観察されています<sup>(2)</sup>。さらにObestatinのラット脳室内投与により、自由な飲水、摂食状態にあるラットの飲水を抑制する作用があることが報告されています。また、Angiotensin II誘導の飲水行動も抑制することが明らかにされています<sup>(3)</sup>。

なお、Obestatin はインスリン分泌や、グルコース代謝には直接的な影響はなく、食欲だけを抑制することにより糖代謝に影響を及ぼしているという報告があります<sup>(4)</sup>。さらに、ラットにおける食欲抑制作用は飲水を抑えることにより二次的に起きたものだと推測されます<sup>(3)</sup>。今後は、Obestatinが関与するエネルギーホメオスタシスと体重調節の研究の展開が期待されています。

今回本研究所において開発されたマウス/ラット Obestatin EIA キットは血清中免疫活性 Obestatin を直接測定を可能にしたもので、これにより生体内 Obestatin の分泌様式や、血中レベル の変動などを検討する上で、有効なツールとして活用できるものであります。

#### YK230 Mouse/rat Obestatin EIA キット

- ▼ 0.082~20ng/mL の範囲で測定できます。
  - ▼ 41 検体を duplicate でアッセイできます。
  - ▼ 血清(検体量 25 μL)サンプルの直接測定ができます。
  - ▼ 測定は 18~20 時間と 1.5 時間で終了します。
  - ▼ プレートは一列(8 ウエル)ずつ取り外しができますので、キットの分割使用が可能です。
  - ▼ 同時再現性  
CV(%) 3.7~6.9 (マウス血清)、3.4~6.7 (ラット血清)
  - ▼ 日差再現性  
CV(%) 4.5~8.4 (マウス血清)、8.1~10.8 (ラット血清)
- |                |  |
|----------------|--|
| 内容             |  |
| 1)測定プレート       |  |
| 2)標準品          |  |
| 3)標識抗原         |  |
| 4)特異抗体         |  |
| 5)SA-HRP 溶液    |  |
| 6)酵素基質液        |  |
| 7)酵素反応停止液      |  |
| 8)緩衝液          |  |
| 9)濃縮洗浄液        |  |
| 10) プレート密閉用シール |  |

#### 保存と安定性

2~8°Cで保存してください。製造日より  
12ヶ月は安定です。

## II. 特徴

本キットはマウスおよびラット血清中に含まれる **Obestatin** を直接且つ特異的に定量するためのキットです。操作は簡便でしかも特異性・定量性に優れ、共存する他の生理活性物質や体液成分の影響を受けにくいなど多くの利点があります。なお、添付のマウス/ラット **Obestatin** 標準品は高純度合成品(純度 99% 以上)であり、表示の重量は絶対量を示しております。

### ＜特異性＞

本キットはマウス/ラット **Obestatin** と 100%、マウス/ラット **Obestatin (11-23)-NH<sub>2</sub>** と 118.6%、マウス/ラット **Obestatin(1-23)-OH** と 0.5%、マウス/ラット/ヒト **Obestatin(1-10)** と 0.39% 以下の交差反応性が認められます。ヒト **Obestatin**、ヒト **Obestatin(11-23)-NH<sub>2</sub>** との交差反応性は認められません。また、マウス/ラット **Ghrelin**、マウス/ラット **des-Ghrelin** との交差反応性も認められません。

### ＜測定原理＞

本アッセイ系は特異性の高いウサギ抗マウス/ラット **Obestatin** 抗体を用いた競合法に、ビオチンと streptavidin の非常に高い親和性を利用した測定法です。

測定プレート(96 ウエル)の各ウエルには、ヤギ抗ウサギ IgG 抗体が固定されています。この各ウエルにビオチン化標準抗原、標準品または検体およびウサギ抗マウス/ラット **Obestatin** 特異抗体を順次加えて競合反応させます。

これに HRP(horse radish peroxidase)結合 SA(streptavidin)を加え、ウエル上に HRP 結合 SA-ビオチン化抗原-抗体複合体を形成させます。最後にこの複合体中の HRP 活性を測定することにより、検体中のマウス/ラット **Obestatin** 濃度を求めることができます。有効測定範囲は 0.082~20ng/mL です。

## III. キットの構成

試薬・器具	形状	規格	内容物	
1. 測定プレート		96 ウエル	1 枚	固定化ヤギ抗ウサギ IgG 抗体
2. 標準品	凍結乾燥品	20ng	1 本	合成マウス/ラット Obestatin
3. 標識抗原	凍結乾燥品	バイアル	1 本	ビオチン化マウス/ラット Obestatin
4. 特異抗体	液状	6 mL	1 本	ウサギ抗マウス/ラット Obestatin 抗体
5. SA-HRP 溶液	液状	12 mL	1 本	HRP 結合したストレプトアビジン
6. 酵素基質液	液状	12 mL	1 本	3,3'5,5'-テトラメチルベンジン (TMB)
7. 酵素反応停止液	液状	12 mL	1 本	1M 硫酸溶液
8. 緩衝液	液状	25 mL	1 本	非特異的反応除去剤を含む緩衝液
9. 濃縮洗浄液	液状	25 mL	1 本	1% Tween20 を含む濃縮生理食塩液
10. プレート密閉用シール		3 枚		

#### IV. 操作法

測定を始める前に必ずお読みください。

(注意:キットに含まれるすべての試薬は室温に戻してから測定を始めてください。)

#### ＜使用器具および装置＞

1. マイクロピペットおよびチップ(25  $\mu$ L～1mL); 8連または12連のマルチチャンネルピペットの使用を薦めます。
2. マイクロプレート用吸光度計(測定波長 450nm で吸光度 2.5まで測定できる装置)。
3. 標準液の調製に使用するポリプロピレン製試験管またはガラス製試験管。
4. マイクロプレート洗浄装置、用手法の場合は連続分注器、ニードルディスペンサー、アスピレーターまたは真空ポンプの使用を薦めます。
5. メスシリンダー(500mL)。
6. 蒸留水または脱イオン水。

#### ＜試薬の調製＞

1. 標準液の調製法:標準品の容器に緩衝液 1mL を加え、内容物を充分溶解させ、20ng/mL の標準液を作製する。この標準液 0.1mLを取り、これを緩衝液 0.2mL で希釈し 6.667ng/mL の標準液を調製する。以下同様の希釈操作を繰り返し、さらに 2.22、0.741、0.247、0.082ng/mL の各標準液を調製する。0ng/mL の標準液は緩衝液そのまま使用する。
2. 標識抗原溶液の調製法:標識抗原の容器に緩衝液 6mL を加え、内容物を充分溶解させてから使用する。
3. 洗浄液の調製法:25mL(全量)を蒸留水または脱イオン水 475mL にて希釈し使用する。
4. その他の試薬はそのまま測定操作に従って使用する。

#### ＜測定操作＞

1. キット内容を室温(20~30°C)に戻す。標準液、標識抗原溶液および洗浄液を上記の試薬調製法に従って調製する。
2. 各ウエルに洗浄液 350  $\mu$ L を加え、30 秒以上放置した後、アスピレーターによって吸引するかプレートを反転して液を除く。この操作を 3 回繰り返し、最後に反転したプレートを紙タオルなどに適切な力でたたきつけるようにして充分液を除く。
3. 各ウエルに標識抗原溶液 50  $\mu$ L を加え、ついで標準液または検体 25  $\mu$ Lを入れ、さらに特異抗体 50  $\mu$ L を加える。
4. 測定プレートをプレート密閉用シールで密閉し、4°Cで 18~20 時間静置する。
5. 各ウエル中の液を除き、洗浄液 350  $\mu$ L を満たした後、2.と同様の洗浄操作を合計 3 回行なう。
6. 各ウエルに SA-HRP 溶液 100  $\mu$ L を加える。

7. 測定プレートをプレート密閉用シールで密閉し、室温で1時間静置する。
8. 各ウエル中の液を除き、2.と同様の洗浄操作を5回行なう。
9. 各ウエルに酵素基質液 100  $\mu$ L を加え、プレートをプレート密閉用シールで密閉し、遮光の状態で室温で30分間静置する。
10. 各ウエルに酵素反応停止液 100  $\mu$ L を加える。
11. マイクロプレート用吸光度計にて 450nm の吸光度を測定する。
12. マウス/ラット Obestatin 標準液の各濃度(6ポイント)の測定値から標準曲線を作成し、検体の測定値を標準曲線に当てはめ、Obestatin の濃度を算出する。


## V. 操作上の注意

1. 血清は分離後ただちに Aprotinin (0.6TIU/mL) を加えてください。血清分離後ただちに測定出来ない場合は血清を適宜小分けし、-30°C 以下で凍結保存してください(長期保存の場合、-80°C の超低温冷凍庫に保存してください)。血清検体は分離後または凍結から融解後プレートに添加するまでは氷冷保存してください。また氷冷下での保存時間は 60 分間を超えないようにしてください。検体の凍結融解を繰り返さないようにしてください。
2. 試薬は、用時調製・希釀を原則としてください。
3. 濃縮洗浄液は保存中に沈殿を生じることがありますが、この沈殿は希釀調製時に溶解します。
4. 洗浄中ウエルに残液が残らないよう反転したプレートを適切な力で充分叩いて除去してください。
5. 検体をウエルに注入する場合は、検体ごとにかならず新しいチップを用い、検体相互間の汚染がないように注意してください。標準液を希釀するときは、希釀段階ごとにかならず新しいチップを使ってください。なお、ピペットの操作は丁寧かつ正確に行ってください。
6. 標準液、検体ともに測定は二重以上の測定で行なってください。
7. キットは分割使用が可能です。溶解(希釀)した試薬(標準品および標識抗原)の残液は-30°C 以下にて凍結保存してください。
8. 酵素基質の発色レベルは、反応温度、時間などでわずかに影響を受けることがありますので、標準曲線は必ず測定毎に作成してください。
9. 発色反応はかならずプレートを遮光して行なってください。
10. 酵素-基質反応停止後は、すみやかに吸光度の測定を行なってください。
11. 試薬の保存中もしくは使用中は、強い光が当たらないように注意して下さい。
12. 本法による測定には、異なるロットのキットを組み合わせて使用しないでください。

## VI. 基本性能

＜測定範囲＞ 有効測定範囲 0.082~20ng/mL

Standard curves of mouse/rat obestatin EIA

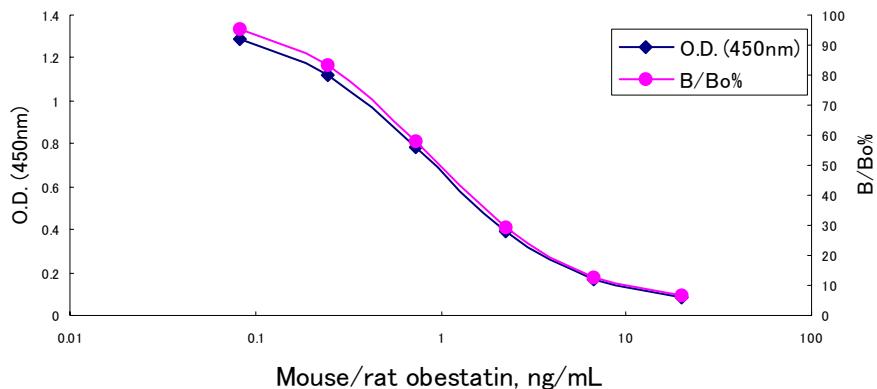

＜再現性＞

同時再現性 CV(%) 3.7~6.9 (マウス血清)、3.4~6.7 (ラット血清)

日差再現性 CV(%) 4.5~8.4 (マウス血清)、8.1~10.8 (ラット血清)

＜添加回収試験＞

マウス血清 (n=4) 102.7~108.9%

ラット血清 (n=3) 85.7~95.7%

＜希釈試験＞

マウス血清、ラット血清とも良好な希釈性を示しました。

## VII. 貯蔵法および有効期間

＜貯蔵＞

遮光し、2~8°Cにて保存してください。

<有効期間>

製造日より 12 ヶ月(使用期限は外箱に表示)

<包装>

1 キット 96 テスト分(標準曲線作成用を含む)

#### VIII. 文献

1. Zhang JV, Ren PG, et al: **Obestatin, a peptide encoded by the ghrelin gene, opposes ghrelin's effects on food intake.** Science 310:996-999, 2005
2. Dun SL, Brailoiu GC, et al: **Distribution and biological activity of obestatin in the rat.** J Endocrinolog 191:1-10, 2006
3. Samson WK, White MM, et al: **Obestatin acts in brain to inhibit thirst.** Am J Physiol: Regulatory, Integrative and Comparative Physiolog 292:R637-643, 2007; Epub 2006 Aug 24
4. Green BD, Irwin N, and Flatt PR: **Direct and indirect effects of obestatin peptides on food intake and the regulation of glucose homeostasis and insulin secretion in mice.** Peptides 28:981-987, 2007; Epub 2007 Feb 12

<お問い合わせ先>

株式会社 矢内原研究所

〒418-0011 静岡県富士宮市栗倉 2480-1

FAX: 0544-22-2770 TEL: 0544-22-2771

<http://www.yanaihara.co.jp> [ask@yanaihara.co.jp](mailto:ask@yanaihara.co.jp)

2007 年8月22日作成